Dr.Web KATANA for Windows Ver.1.0
インストールガイド

株式会社 Doctor Web Pacific

初版 ： 2015/11/04
改訂 ： 2017/03/29

Copyright © Doctor Web Pacific Inc. All rights reserved.

目次

1. はじめに 3
1.1 ライセンス証書の受領 3
1.2 ライセンス証書に含まれる内容 3
2. 環境前提条件 3
3. 準備 4
3.1 インストール環境の確認 4
3.2 ファイル 4
4. インストール 5
5. インストール後の Dr.Web KATANA の確認 9
6. ケーススタディ 10
6.1 プロキシサーバーの設定 10
6.2 更新頻度の変更 13
6.3 隔離されたファイルの確認・復元 14
6.3.1 隔離されたファイルの確認 14
6.3.2 隔離されたファイルの復元 15
6.4 アプリケーションの例外設定 16
6.5 ライセンス更新 20

Copyright © Doctor Web Pacific Inc. All rights reserved.

この度は、株式会社 DoctorWebPacific の製品をご購入いただき、誠にありがとうございます。本ガイドは、初めて弊社製品をご利用いただくお客様向けに、弊社ソフトウェア(Dr.Web KATANA for Windows)をインストールいただくための手順を説明する資料となります。なお、詳細な機能や操作の説明に関しましては、製品マニュアルをご参照ください。

1. はじめに

1.1 ライセンス証書の受領

ライセンス証書は、Doctor Web Pacific(以下、DWP)または、DWP パートナー企業より、電子メールか郵送もしくはその両方の方法で、お客様へ送付いたします。

1.2 ライセンス証書に含まれる内容

ライセンス証書には、以下のライセンスに関する情報が記載されておりますので、大切に保管してください。

- customer (お客様情報)
- product(購入製品名)
- serial number(製品用キーコード)
- license term(ライセンス期間)
- protected objects (購入ライセンス数)

2. 環境前提条件

本書は、下記の環境で動作確認の上作成しております。

- OS：Windows 8.1 (64bit)
- ブラウザ ：Internet Explorer 11

Copyright © Doctor Web Pacific Inc. All rights reserved.

3. 準備

3.1 インストール環境の確認

- Dr.Web 製アンチウイルスソフトウェアのアンインストール

  Dr.Web KATANA for Windows バージョン 1.0(以下、Dr.Web KATANA)のインストールを実行される前に、インストール対象の PC に Dr.Web 製アンチウイルスソフトウェアがインストールされていなことをご確認ください。

  Dr.Web 製アンチウイルスソフトウェアがインストールされている場合、完全に削除(アンインストール)を実施後、Dr.Web KATANA のインストールを実行してください。

- プロキシサーバーの利用

  プロキシサーバーを利用している場合、プロキシサーバーのアドレス、ポート等プロキシサーバーを利用する際に必要な情報を確認してください。

※ メモリ、HDD 容量等については、インストールマニュアルを参照してください。

3.2 ファイル

以下のファイルを用意してください。

インストールファイルおよび Key ファイルの入手方法については、「Dr.Web ダウンロード＆アクティベーションガイド」を参照してください。

- インストーラー

  Windows 用のインストールファイルを用意し、インストール対象の PC にコピーしてください。

- Key ファイル

  インストール対象の PC にコピーしてください。

Copyright © Doctor Web Pacific Inc. All rights reserved.

4. インストール

1) インストール対象の端末にコピーした、インストールファイルを実行します。

2) 「ユーザーアカウント制御」の画面が表示されたら、「はい」ボタンをクリックします。

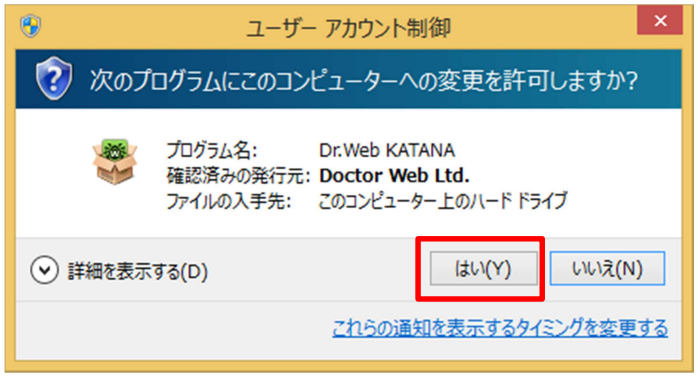

図 1. ユーザーアカウント制御

※ プログラムが実行されると、下記の画像が表示されます。

図 2. プログラム開始

Copyright © Doctor Web Pacific Inc. All rights reserved.

3) 以下の画面が表示されたら、ライセンス使用許諾契約を確認の上、「次へ」ボタンをクリックします。以下の 2 項目については、必要に応じてチェックを入れてください。

- Dr.Web Cloud に接続します

図 3. ライセンス同意

Copyright © Doctor Web Pacific Inc. All rights reserved.

4) 「登録ウィザード」の画面が表示されたら、「有効なキーファイルのパスを指定する」にチェックを入れ、「参照」ボタンをクリックし、予め PC 上に保存した Key ファイル選択し、「インストール」ボタンをクリックします。
≪注意≫クリックする前に、必ず Dr.Web 製アンチウイルスソフトウェアがインストールされていないことを確認してください。

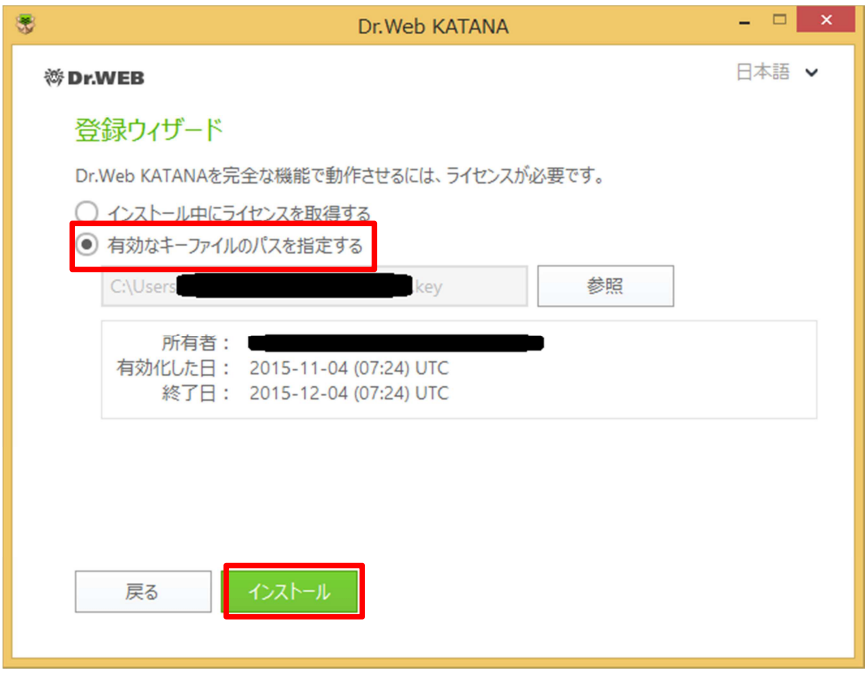

図 4. ライセンス登録&インストール開始

5) インストールが開始します。

図 5. インストールプロセス

Copyright © Doctor Web Pacific Inc. All rights reserved.

6) 「インストールが完了しました」と画面に表示されたら、「準備完了」ボタンをクリックします。

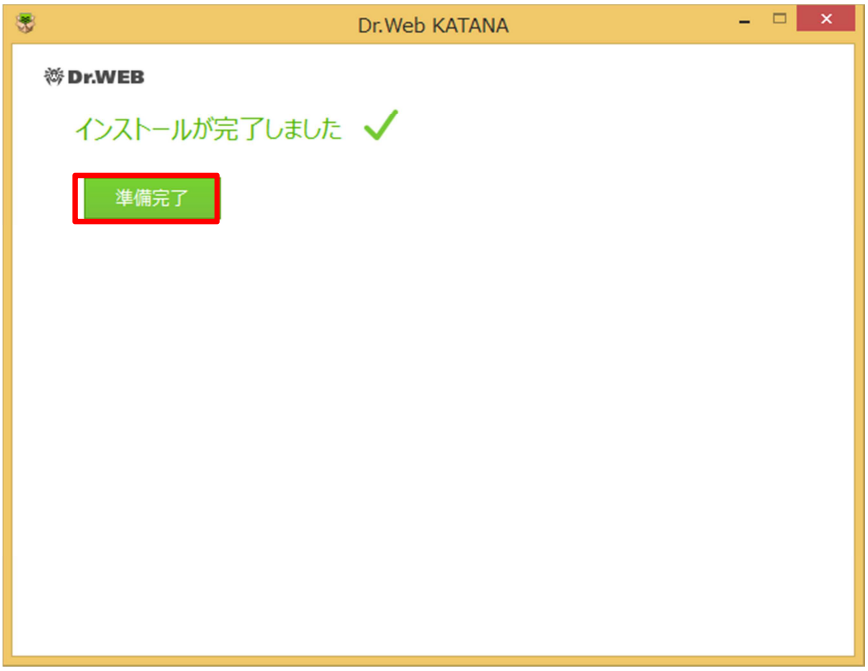

図 6. インストール完了

7) 「優先度の高い更新が行われました」と画面に表示されたら、「すぐに再起動」ボタンをクリックします。

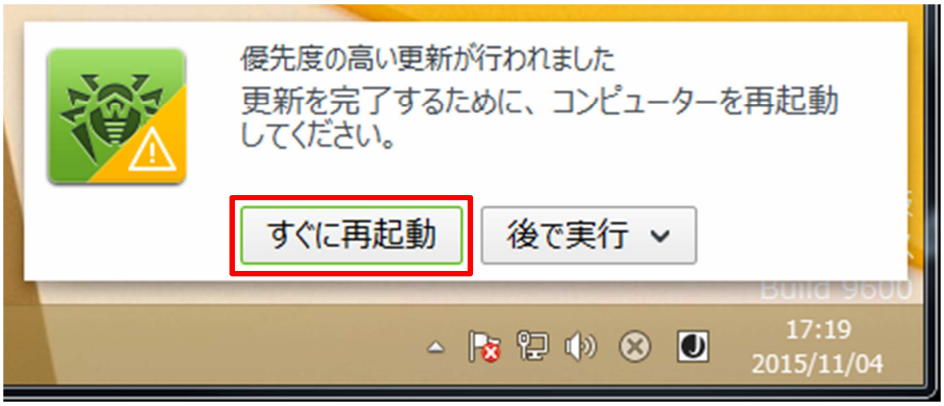

図 7. 再起動

Copyright © Doctor Web Pacific Inc. All rights reserved.

5.　インストール後の Dr.Web KATANA の確認

インストールされた Dr.Web KATANA は、デスクトップ画面の右下の常駐アイコンにて表示されます。

Dr.Web KATANA の常駐アイコンが、以下のような状態でしたら問題なく動作しています。

※　Dr.Web KATANA のアイコンが見当たらない場合は、△マークをクリックして、隠れているインジケーター内を確認してください。

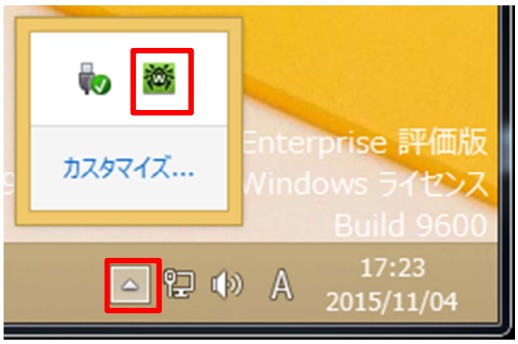

図 8.　Dr.Web KATANA アイコン

Copyright © Doctor Web Pacific Inc. All rights reserved.

6. ケーススタディ

6.1 プロキシサーバーの設定

1) Dr.Web KATANA の常駐アイコンをクリックします。

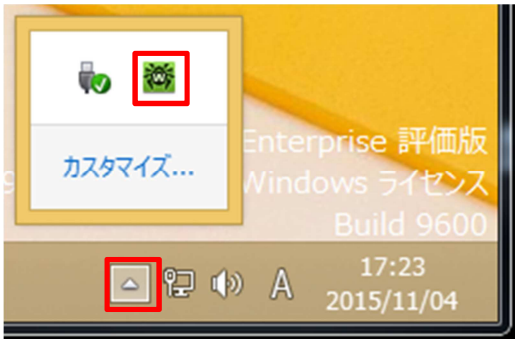

図 9. Dr.Web KATANA アイコン

2) 表示されたメニューから、「歯車」アイコンをクリックします。

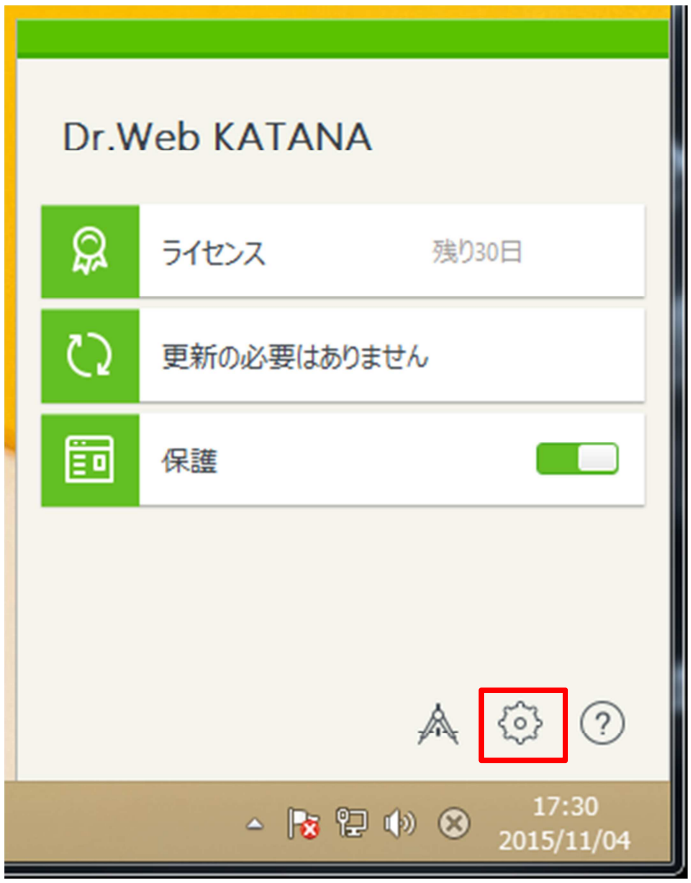

図 10. メニュー

Copyright © Doctor Web Pacific Inc. All rights reserved.

3) 「設定」画面が表示されたら、「更新」をクリックします。

図 11. [設定]-[メイン]

4) 「プロキシサーバを使用する」を「オン」に変更します。

図 12. [設定]-[更新]

Copyright © Doctor Web Pacific Inc. All rights reserved.

5) 「プロキシサーバーのパラメータ」画面が表示されるので、プロキシサーバーのアドレスやポート等を入力し、「OK」ボタンをクリックします。

図 13. プロキシサーバーのパラメータ

6) 「メイン」画面にて、以下を確認し閉じます。

- 「プロキシサーバーを使用する」が「オン」に変更されたこと。
- 指定したプロキシサーバーのアドレス

図 14. [設定]-[更新]

Copyright © Doctor Web Pacific Inc. All rights reserved.

6.2 更新頻度の変更

Dr.Web KATANA では、コンポーネント等の更新頻度を初期値の 30 分から変更することができます。

1) Dr.Web KATANA 常駐アイコンをクリックします。
2) 表示されたメニューから、「歯車」アイコンをクリックします。
3) 「設定」画面が表示されたら、「更新」をクリックします。
4) 「更新頻度」のプルダウンリストから、設定したい更新頻度を選択し閉じます。

図 15. [設定]-[更新]

Copyright © Doctor Web Pacific Inc. All rights reserved.

6.3 隔離されたファイルの確認・復元

6.3.1 隔離されたファイルの確認

1) Dr.Web KATANA の常駐アイコンをクリックします。

2) 表示されたメニューから、「コンパス」アイコンをクリックします。

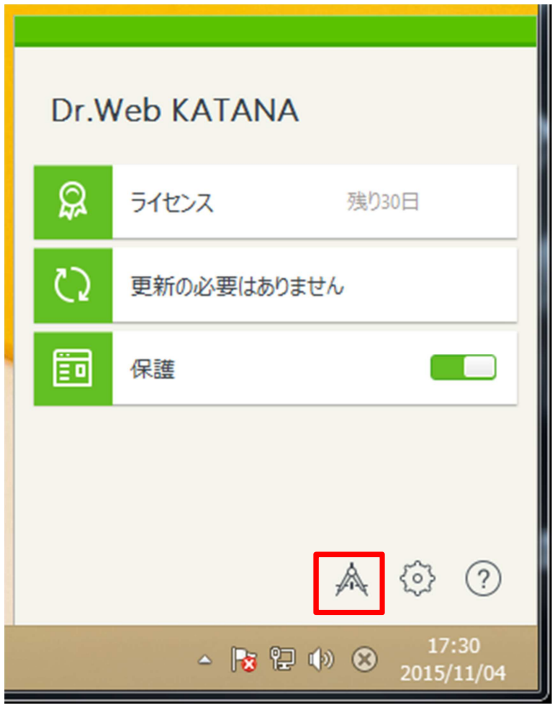

図 16. メニュー

3) 「ツール」メニューから、「隔離マネージャ」をクリックします。

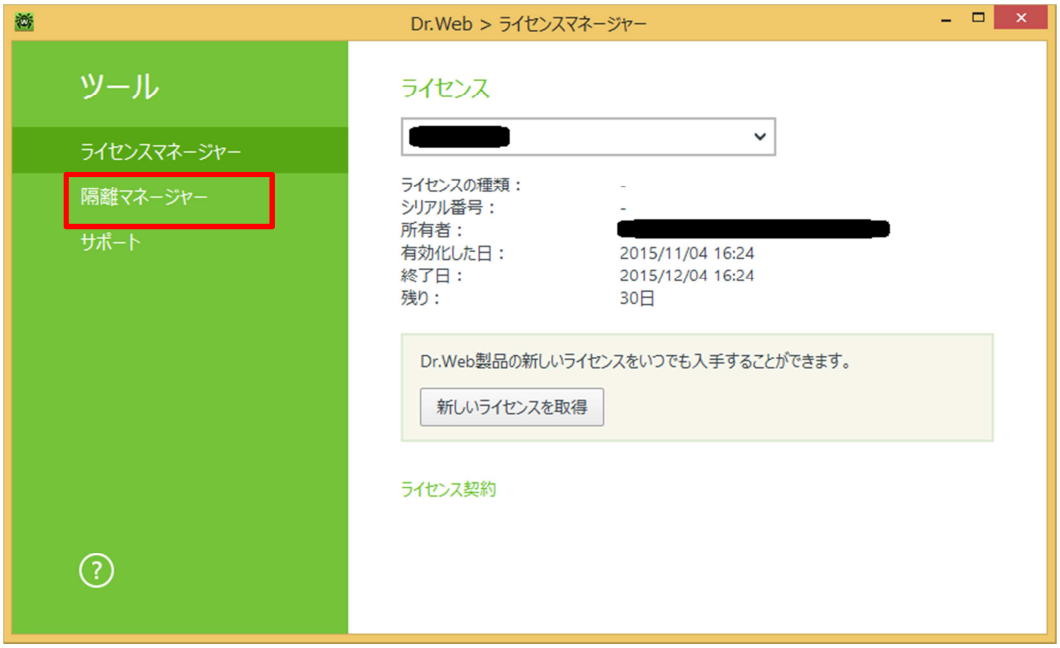

図 17. 「ツール」メニュー

Copyright © Doctor Web Pacific Inc. All rights reserved.

4) 「隔離マネージャ」画面が開き、隔離されているファイルの一覧が表示されます。

図 18.　隔離マネージャ

6.3.2　隔離されたファイルの復元

1) 6.3.1 の手順にて「隔離マネージャ」を開きます。

2) 復元したいファイルを選択し、「復元」アイコンをクリックします。

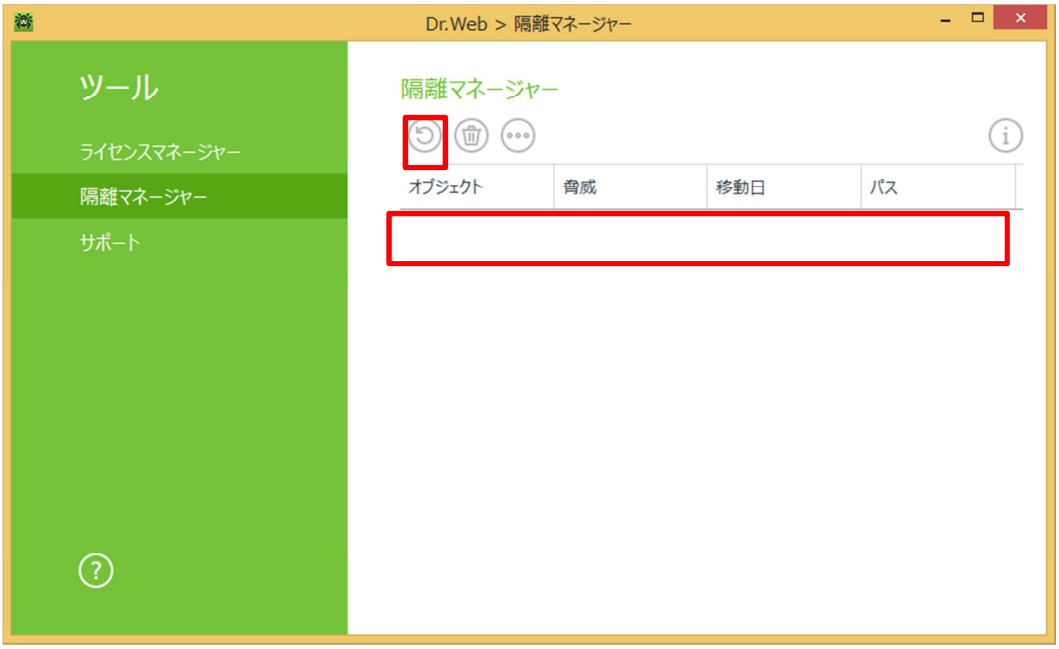

図 19.　隔離マネージャ

Copyright © Doctor Web Pacific Inc. All rights reserved.

3) 「隔離から復元」画面が表示されるので、表示されている内容を確認し、「復元」ボタンをクリックします。

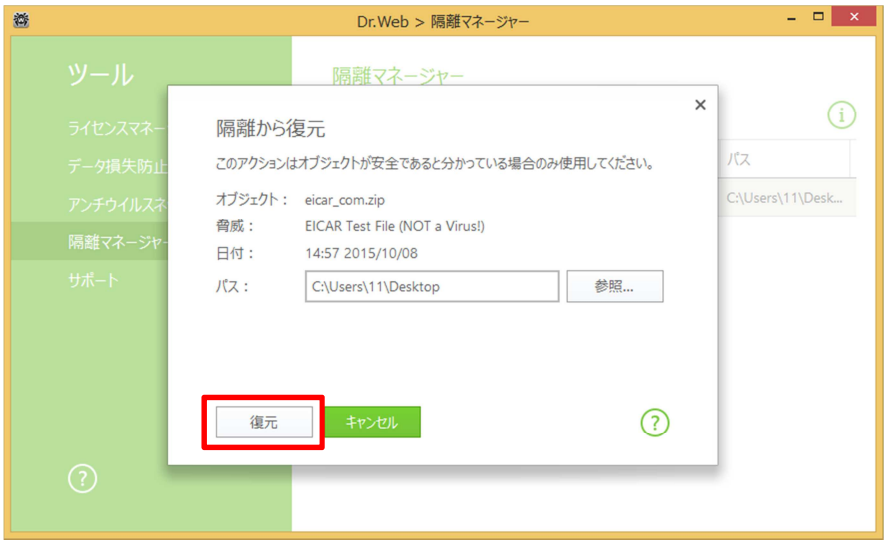

図 20. 隔離から復元

6.4 アプリケーションの例外設定

1) Dr.Web KATANA の常駐アイコンをクリックします。

2) 表示されたメニューから、「歯車」アイコンをクリックします。

3) 「設定」画面が表示されたら、「保護」をクリックします。

図 21. 設定

Copyright © Doctor Web Pacific Inc. All rights reserved.

4) 「保護」画面から「アプリケーションのアクセスパラメータを変更」をクリックします。

図 22. [設定]-[保護]

5) 「アプリケーション」画面の「＋」ボタンをクリックします。

図 23. アプリケーション(1)

Copyright © Doctor Web Pacific Inc. All rights reserved.

6) 「アプリケーションルール」画面から「参照」ボタンをクリックし、例外設定を行なうアプリケーションを指定します。

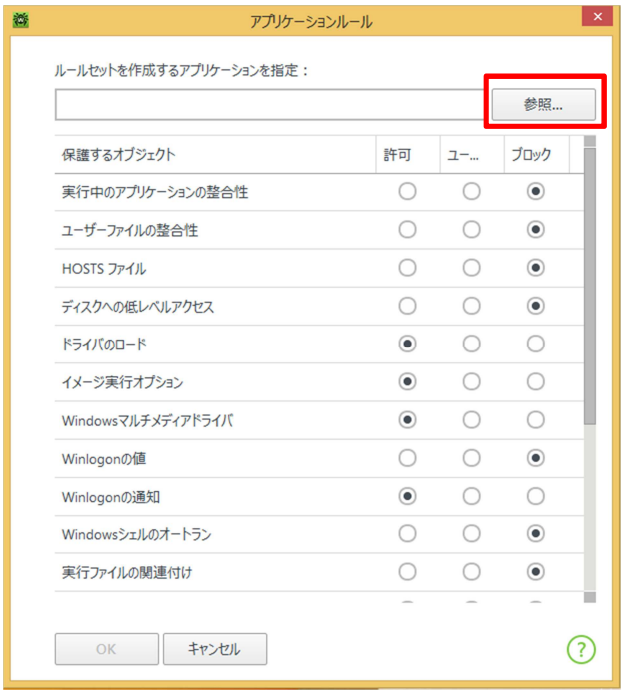

図 24. アプリケーションルール(1)

7) 例外設定を行なうアプリケーションを指定した後、各オブジェクトに対するパラメータを指定し、「OK」ボタンをクリックします。

図 25. アプリケーションルール(2)

Copyright © Doctor Web Pacific Inc. All rights reserved.

8) 「アプリケーション」画面に追加されたことを確認します。

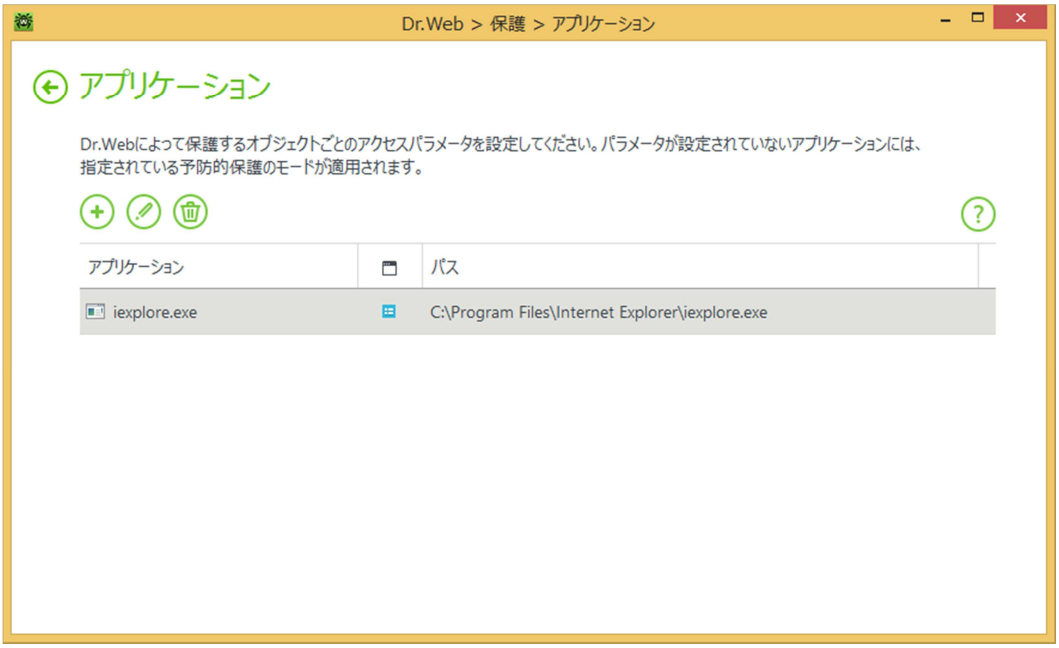

図 26. アプリケーション(2)

Copyright © Doctor Web Pacific Inc. All rights reserved.

6.5 ライセンス更新

※　更新されたライセンスキーファイルを用意した上で実施してください。

1)　Dr.Web KATANA の常駐アイコンをクリックします。

2)　表示されたメニューから、「ライセンス」をクリックします。

図 27.　メニュー

3)　「ライセンスマネージャ」画面が表示されたら、「新しいライセンスを取得」ボタンをクリックします。

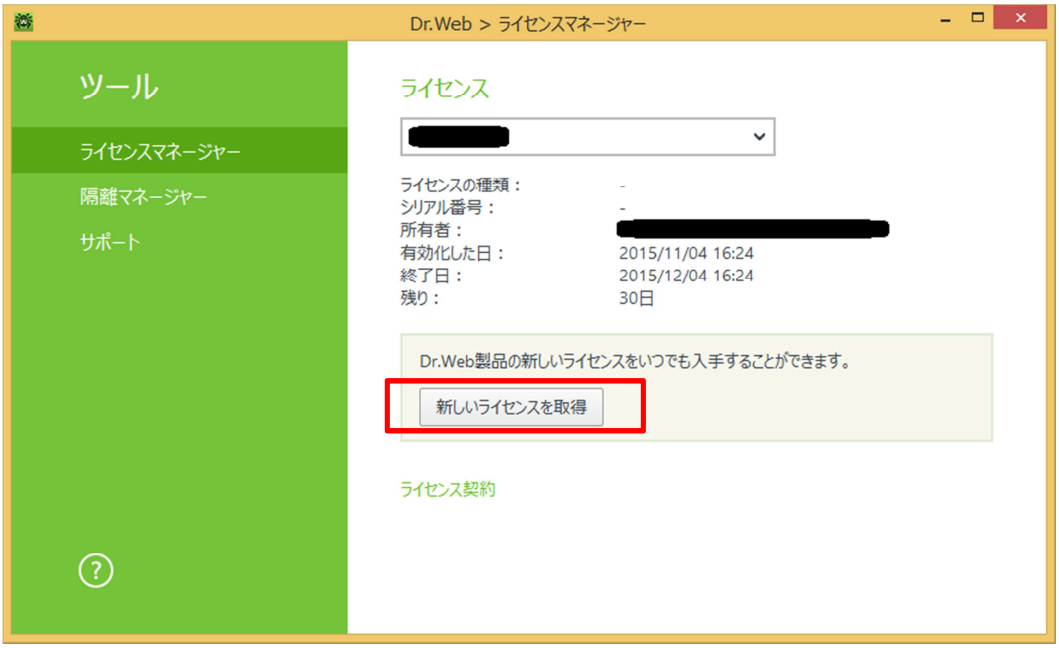

図 28.　ライセンスマネージャ

Copyright © Doctor Web Pacific Inc. All rights reserved.

4) 「ライセンスの有効化」画面が表示されたら、「他の種類の有効化」をクリックします。

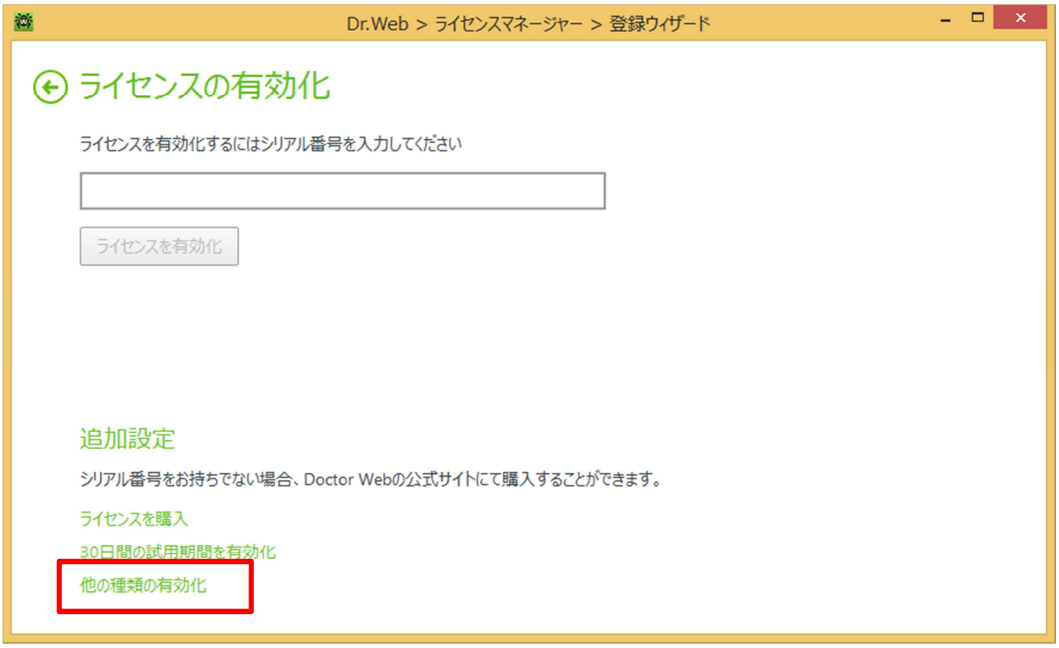

図 29. [登録ウィザード]-[ライセンスの有効化]

5) 「キーファイル」画面が表示されたら、「参照」ボタンをクリックし、更新されたライセンスキーファイルを指定します。

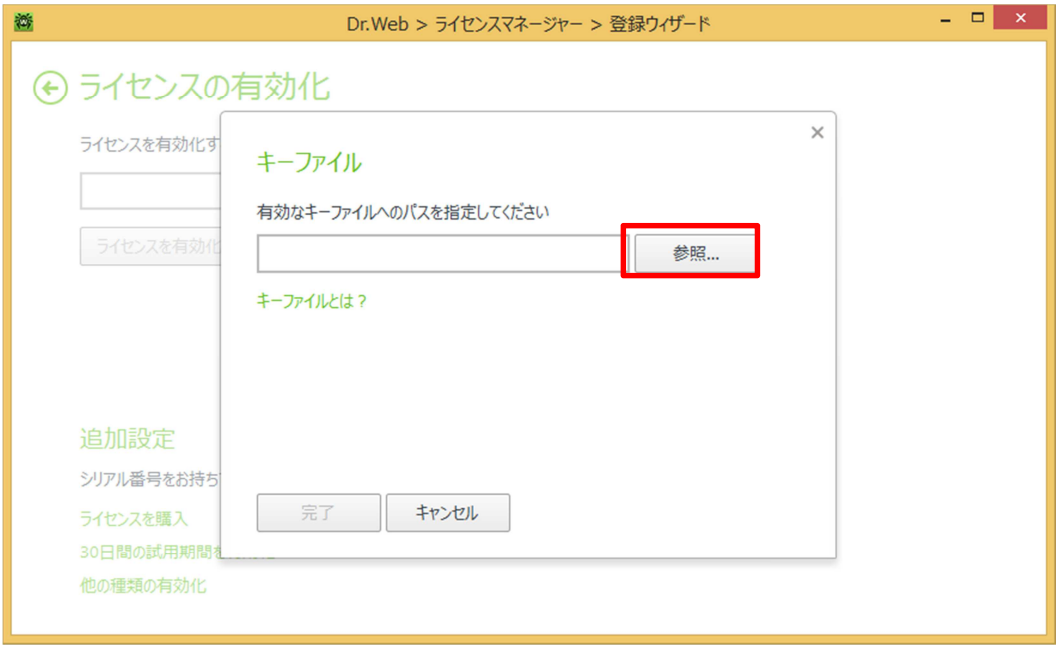

図 30. [登録ウィザード]-[キーファイル]

Copyright © Doctor Web Pacific Inc. All rights reserved.

6) キーファイルを指定し、表示された所有者情報、終了日等の情報に誤りがないことを確認し、「次へ」ボタンをクリックします。

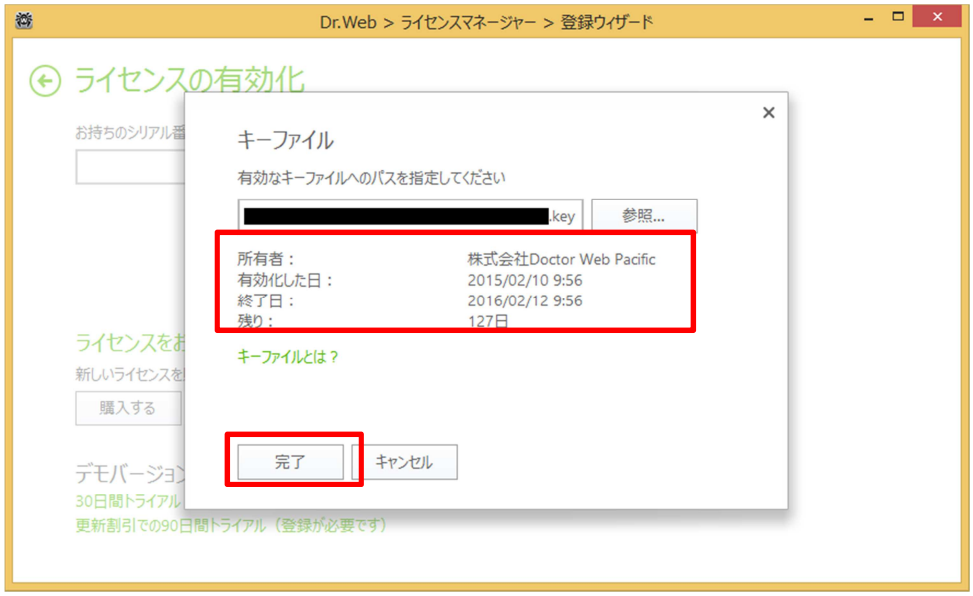

図 31. [登録ウィザード]-[キーファイル]

7) 「ライセンスマネージャ」画面が表示されたら、新しいライセンスが登録されたことを確認します。

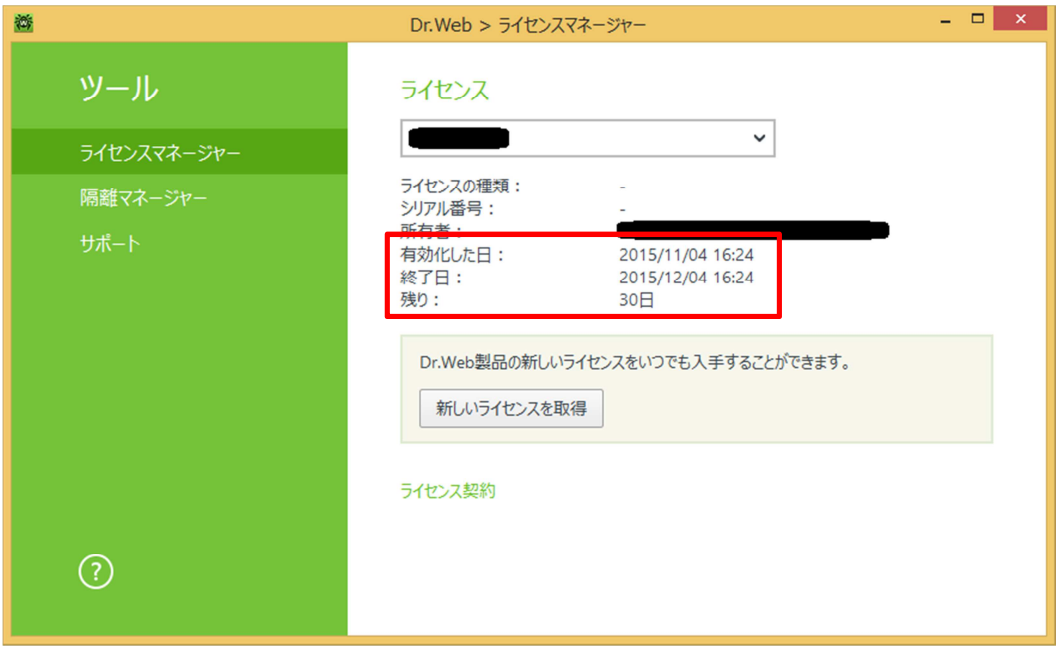

図 32. ライセンスマネージャ

Copyright © Doctor Web Pacific Inc. All rights reserved.

お使いの製品の詳細な機能の説明や、利用方法は、各製品マニュアルをご参照ください。
また、製品のご利用について、ご質問やトラブル等がありましたら、下記 URL よりお気軽にお問い合わせください。

https://support.drweb.co.jp/support_wizard/

株式会社 Doctor Web Pacific
〒210-0005 神奈川県川崎市川崎区東田町 1-2 いちご川崎ビル 2F
URL：www.drweb.co.jp

Copyright © Doctor Web Pacific Inc. All rights reserved.